



【薬事委員会より】


1. 期限切れ医薬品の連絡

アドナ錠は要時発注品となりました。

2. 薬局からお知らせ

1) ECT施用時の鎮静薬の払い出し方法を変更いたします。

当院ではECT施用時の鎮静薬としてプロポフォール注，ドルミカム注などが使用されます。不正使用や紛失などの観点から保管方法について運用を変更いたします。下記フローチャートにより，ご確認ください。詳細は「2020年1月薬事委員会議事録」をご確認ください。

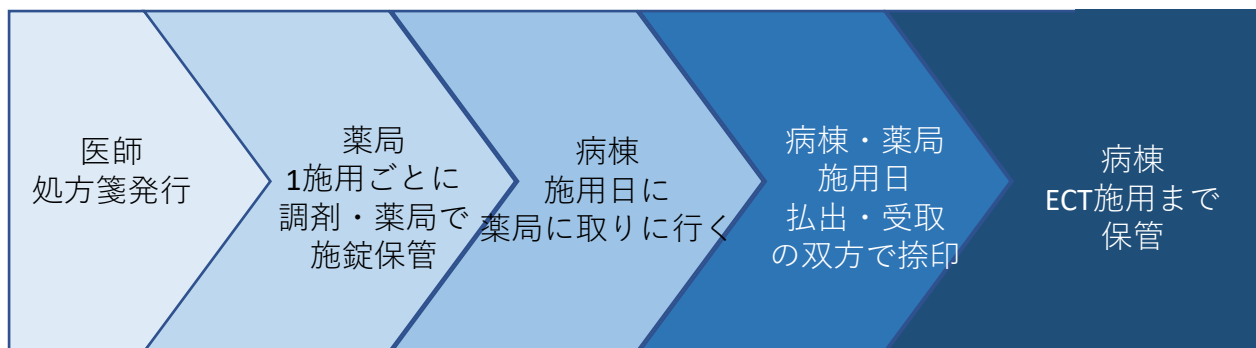

2) トリンテリックス錠の採用について  
現在，本部にて審議中。


## リスパダールコンスタ筋注用に関する液漏れについて

当院にてリスパダールコンスタの調整時に液漏れがありました。メーカーに返却した際にデバイス(キット)の不具合ではなく手技上の問題であったことがわかったので報告いたします。

液漏れの原因として、バイアルのゴム栓をアダプターの針が貫通していなかったことが挙げられました。

このことは取り扱い説明書にも記載があります。再度、リスパダールコンスタキットの調整の際は取り扱い説明書をご確認いただき調整をお願いいたします。

### 3 アダプターの装着



バイアルを机等の上に置き、手で支える。  
アダプターをバイアルのゴム栓の中央に、上から真っ直ぐカチリと音がするまで押し込み、装着する。



**アダプターを斜めに装着すると、液漏れがおこることがある。**

(スパイクチップが曲がったり、バイアルのゴム栓を完全に貫通しないため、液漏れの原因となる。)



写真1 アダプターおよび、シリンジが接続されたバイアル




写真2 バイアルのゴム栓



写真4 アダプター